



Laboratorio Metrologico e Verificazione Strumenti

TEL : 0984/401531
e-mail: metrologiamelicchio@gmail.com
info@metrologiamelicchio.com
www.metrologiamelicchio.com

METROLOGIA MELICCHIO SRL
P.IVA 03012300780
C/da Lecco - Zona Industriale
Via P.A. - Cabrai (Palazzo Manhattan)
87036 - Rende (CS)

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



RAPPORTO DI TARATURA BILANCIA

N° R.t.
MM/2008/2023

Committente	Ditta	Indirizzo	Città (Prov)
	COSTRUIRE SRL	VIA CAVOUR 33 87036 RENDE (CS) U.O C.DA GIDORA Z.I 87040 LUZZI (CS)	

Strumento da verificare	Tipologia	Costruttore	Modello	Matricola	Ubicazione	Classe
	BILANCIA	TECNOTEST	QHW-30	2125025045		NO
	Unità di formato 5 g	Campo di misura da/a 0 30	Unità Kg	Limiti accettabilità(se noti)	Controllo 12 mesi	

Strumento campione	Tipologia	Costruttore	Modello	Matricola	Classe
	PESIERA	CIBE		B4753	F1
	MASSA	CIBE		B4753	F1
	Unità di formato	Campo di misura	Centro taratura	Certificato	
		1 [mg] - 10 [Kg] 20 [Kg]	LAT 117 LAT 261	22-M-0350 62-1364-23	
E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali					

Strumento di supporto	Tipologia	Costruttore	TIPO
	PESIERA	CIBE	1 [mg] - 10 [Kg]

Procedura	Istruzione di Taratura di Balance IS.OP/01/BIL REV1
-----------	---

Norme di rif.	UNI 10699 – 1, Linee Guida SIT per la Tarature di balance SIT/Tec-003/03
---------------	--

Ambiente	Temperatura 21°	Pressione atmosferica	Umidità 55%UR
----------	-----------------	-----------------------	---------------

RILEVAZIONI - valori espressi in : Kg						
Carico Nominale ₁	Errore medio ₁ Kg	Incertezza Estesa ₁		Carico Nominale ₂	Errore medio ₂ Kg	Incertezza Estesa ₂
0,00	0,0000	0,0190				
3,00	0,0000	0,0190		18,00	0,0000	0,0190
6,00	0,0000	0,0190		21,00	0,0000	0,0190
9,00	0,0000	0,0190		24,00	0,0000	0,0190
12,00	0,0000	0,0190		27,00	0,0000	0,0190
15,00	0,0000	0,0190		30,00	0,0000	0,0190


Strumento/apparecchiatura/dispositivo	IDONEO	ai limiti di accettabilità adottati
---------------------------------------	--------	-------------------------------------

Note:

N° R.t. MM/2008/2023

Eccentricita'

Indicare lo schema di decentramento del carico utilizzato:

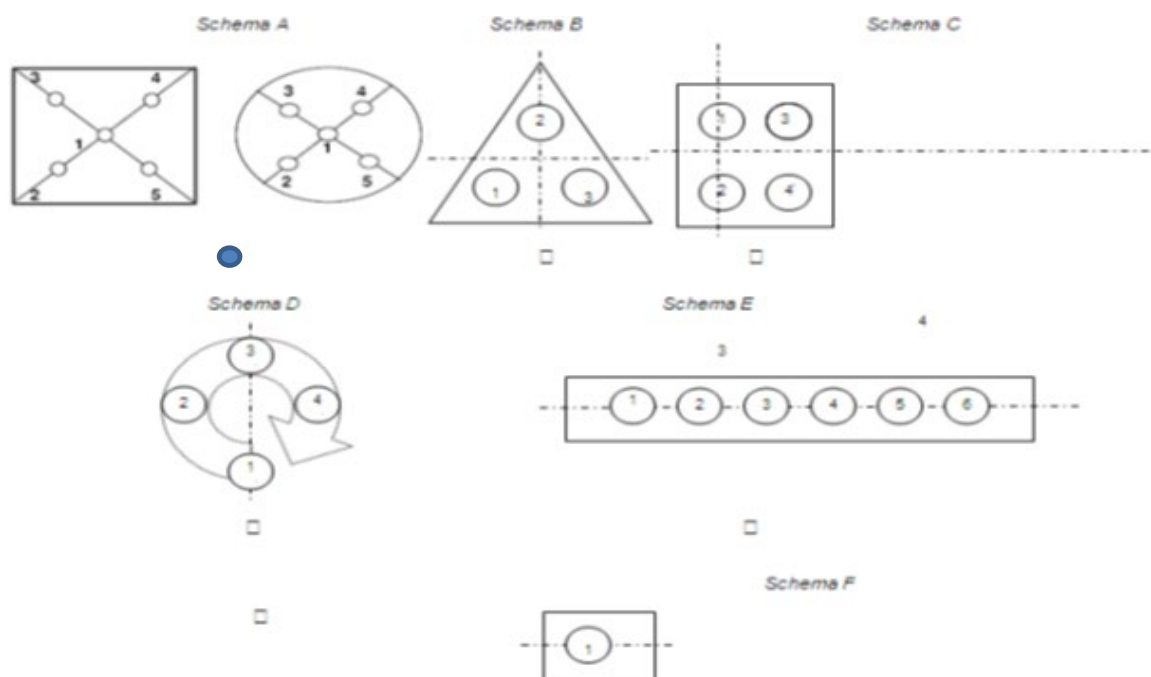

Unità di misura= Kg

Posizione di misura	Massa Campione	Indicazione bilancia	Errore max ass.
1	15	15,000	0
2	15	15,000	0
3	15	15,000	0
4	15	15,000	0

d= 0,005

Controllo effettuato da
Riccardo Dell'Armi

Data del controllo	19/10/2023
Data Emissione Rapporto	19/10/2023

Modello	Revisione	Data Rev.
MM/SERV/RAP.TAR./23-BIL	01	23/01/2017